

BIURO PROJEKTOWE:

Medpipe Sp. z o.o.  
plac Rodła 8 (PAZIM)  
70-419 Szczecin

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

Medpipe Sp. z o.o.  
Niemierzuńska 17a  
71-441 Szczecin  
[www.medpipe.pl](http://www.medpipe.pl)

Telefon: +48 9 18 17 17 18  
Email: [info@medpipe.pl](mailto:info@medpipe.pl)



## MEDYCZNE STACJE PRÓŻNI ULTRAVAC

Wyrób medyczny zgodny z 93/42/EEC i ISO 7396-1, posiadający aprobatę CE0120



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Układ pionowy - oszczędność powierzchni.
- Elektroniczne panele sterujące.
- Niskie koszty eksploatacji.
- Styki bezprądowe do podłączenia do BMS.
- Łatwość transportu i obsługi.
- Łatwa dostępność do części i serwisu.
- Pełna automatyka - system bezobsługowy.
- Elektroniczne panele sterujące.
- Niskie koszty eksploatacji.
- Styki bezprądowe do podłączenia do BMS.
- Zasilanie elektryczne 3x400V.
- Własna szafa sterowniczo-zabezpieczająca.

### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE


- 1, 2 lub 3 pompy próżni w układzie pionowym lub poziomym.
- 2 filtry bakteriologiczne z zaworami różnicowymi oraz naczyniami obserwacyjnymi.
- Panel sterujący z podłączeniem do BMS.
- 1 lub 2 zbiorniki poziome lub pionowe.
- Spust kondensatu.

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Możliwość podłączenia do sieci Ethernet lub LAN.
- Dotykowy kolorowy panel sterujący QuVac.
- Wysyłanie raportów o błędach przy pomocy SMS.
- Komunikacja przy pomocy protokołu modbus.
- Dodatkowe czujniki podciśnienia.
- Dostępne różne konfiguracje.
- Dostępne wydajności pomp w zakresie od 3 do 1600 m<sup>3</sup>/h.

## PODSTAWOWE MODELE I KONFIGURACJE

MODEL	Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	Moc [kW]	Pojemność zbiornika [L]	Poziom hałasu [dB (A)]	Wymiary [mm]	Waga [kg]
3.10/200	3 x 10	3 x 0,37	200	60	1500x600x1500	180
3.15/200	3 x 15	3 x 0,55	200	61	1500x600x1500	180
3.20/200	3 x 20	3 x 0,55	300	63	1680x800x2000	210
3.25/300	3 x 25	3 x 0,75	300	58	1680x800x2000	225
3.50/500	3 x 50	3 x 1,25	500	65	2100x800x2000	345
3.75/500	3 x 70	3 x 1,85	500	66	2100x800x2000	360
3.100/1000	3 x 110	3 x 2,2	1000	67	2900x1000x2200	580
3.150/1000	3 x 150	3 x 3,0	1000	69	2900x1000x2200	600
3.200/1000	3 x 200	3 x 4,0	1000	71	3150x1200x2200	760
3.300/1000	3 x 300	3 x 5,5	1000	74	3150x1200x2200	940

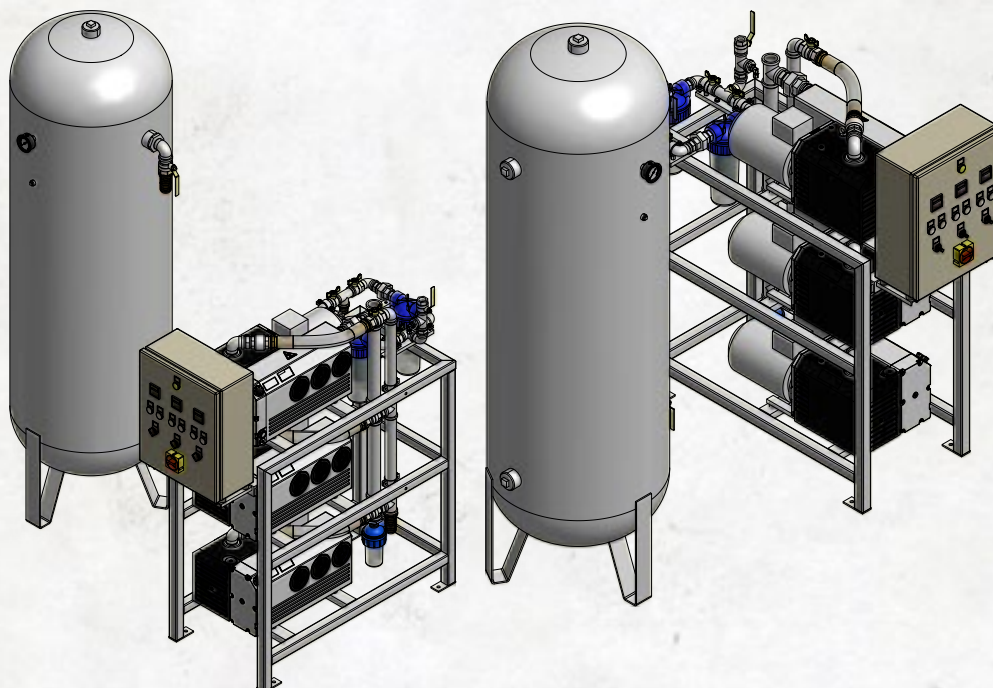

### W Y M Ó G P R A W N Y

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej art. 17 podmioty lecznicze obowiązane są stosować wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.